



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS, IP
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE BENS E SERVIÇOS

Concurso Público nº 58A001241/CP/01/OE-MED/026
Fornecimento de Medicamentos Essenciais e de Especialidade para o SNS

Nota: Nº 288 679/CMAM/026

Maputo, 17 de Fevereiro de 2026

ADENDA Nº 01

Exmos. Senhores,

Nos termos do artigo 52 do Regulamento de Contratação Pública de Bens e Serviços aprovado pelo Decreto 79/2022 de 30 de dezembro, foi emitida uma adenda ao documento do concurso de acordo com o seguinte:

1. Ficam reduzidas as quantidades dos produtos abaixo:

FNM	Produto	Forma Farmacêutica	Dosagem	Necessidade Inicial	Necessidade Atualizada
01G02	Nitroglicerina	Comprimido Sblingual	0,5mg	592,344	37,544
01G03	Nitroglicerina	Injectável	5mg/ml	22,000	12,000
07D04	Fenitoina	Comprimido	100mg	9,641,000	3,000,000
07G01	Amitriptilina	Comprimido	10mg	4,580,125	2,000,000
07J16	Risperidona	Comprimido	3mg	481,645	333,700
09D04	Vincristina	Injectável	2mg/2ml	35,800	15,345
19A06	Soro antiofídico polivalente	Injectável	10ml; Fr. 10ml	27,460	6,000

2. São cancelados da lista do concurso os produtos abaixo:

FNM	Produto	Forma Farmacêutica	Dosagem
07J05	Flufenazina	Injectável	25mg/2ml
08Q0ZZ	Fluconazol	Suspensão Oral	50mg/5ml Fr. 100 ml
12C01	Cálcio-Carbonato	Comprimido	500mg

3. Fica alterada a dosagem inicial requerida do produto abaixo:

FNM	Produto	Forma Farmacêutica	Dosagem Inicial	Dosagem Necessária
08Q02	Fluconazol	Cápsula	50mg	200mg

4. São acrescidas as quantidades dos produtos abaixo:

FNM	Produto	Forma Farmacêutica	Dosagem	Necessidade Inicial	Necessidade Atualizada
18A04	Sevoflurano	Líquido Volátil	100% v/v Fr. 250ml	4,598	11,136
18A02	Isoflurano	Líquido Volátil	100% v/v Fr. 250ml	7,349	11,160



CMAM
Central de Medicamentos
e Artigos Médicos

Av. de Moçambique, EN1, Bairro do Zimpeto Nrº 847
Cidade de Maputo

ESCLARECIMENTO Nº 01

Nos termos do estatuído na cláusula nº10 do Caderno de Encargos, vimos pela presente prestar os seguintes esclarecimentos:

1. **Questão:** 01A01-Digoxina Comprimido 250mcg. Trata-se de dosagem em mcg or mg?
Resposta: Trata-se de 250mcg
2. **Questão:** 01B02-Amiodarona Comprimido 200mg. Qual e a fórmula farmacêutica solicitada, comprimido ou injetável?
Resposta: Comprimidos
3. **Questão:** 01F02-Nifedipina Comprimido. Trata-se de comprimido de acção prolongada ou regular?
Resposta: Acção Prolongada
4. **Questão:** 01F02Z-Nifedipina Comprimido 10mg. Trata-se de comprimido de acção prolongada ou regular?
Resposta: Acção Regular (Curta duração)
5. **Questão:** 07A04-Paracetamol Injectável "1g/100ml Fr 100ml (EV)" não pode ser ampola, trata-se de frasco?
Resposta: Trata-se de frasco
6. **Questão:** 09D04-Cálcio-Carbonato Comprimido 500mg. Trata-se de injectável ou comprimido?
Resposta: Trata-se de Comprimidos (Atenção ao código trata-se de 12C01 e não 09D04)
7. **Questão:** 17C01-Aciclovir pomada oftálmica 0,3% tubo. Quantas gramas por tubo?
Resposta: 4.5g
8. **Questão:** 17C07-Tetraciclina Pomada Oftálmica 1%". Quantas gramas por tubo?
Resposta: 4g
9. **Questão:** 23C03-Gaze Hidrófila Rolo 90 cm x 100 m. Qual é o peso do produto? 1.8kg ou 2.4kg?
Resposta: Peso: 2,4 Kg; Malha: 17 fios/cm².
10. **Questão:** 23D03-Ligadura De Cambraia Rolo 10cm x 10m . Quais são as Especificações?
Resposta: Malha de 7 fios/cm²
Sem ourela
Embaladas individualmente em celofane + em caixa de 12 + caixa de transporte
Malha: 7 fios/cm²
Peso: aprox. 13,5g/m².
Peso: Limite de tolerância ± 10%
Largura: Limite de tolerância ± 10%
Comprimento: Limite de tolerância ± 1%



Produto com validade

11. **Questão:** O menor preço vence – isso está correto ou os produtos registados vencem os produtos não registados que têm um preço mais baixo?
Resposta: Os produtos registados vencem os produtos não registados que têm um preço mais baixo.
12. **Questão:** Exigência de 3 ou mais ofertas de um produto registado específico para eliminar quaisquer ofertas de produtos não registados. São 3 produtos/fabricantes diferentes ou pelo menos 3 ofertas potencialmente do mesmo produto/fabricante?
Resposta: 3 ofertas com registo do mesmo produto/fabricante.
13. **Questão:** Exigência de prazo de validade de 85% (menos de 3 meses) – altamente limitante para um carregamento de vários produtos/fabricantes. O CMAM pode considerar uma exigência de prazo de validade de 70% como aceitável?
Resposta: Não.
14. **Questão:** O Incoterm DAP exclui ou inclui o desembaraço aduaneiro para o fornecedor?
Resposta: Inclui o desembaraço aduaneiro pelo fornecedor e demais formalidades aduaneiras, excluindo o pagamento de direitos aduaneiros para os produtos sujeitos.
15. **Questão:** Podemos oferecer tamanhos de embalagem alternativos?
Resposta: Pode.
16. **Questão:** Para alguns itens, a solicitação é de embalagem blister. É aceitável oferecer um frasco em vez de blister? Exemplo: item nº 1. A solicitação é de uma embalagem com 10 comprimidos. Podemos oferecer um frasco com 100 ou 1000 comprimidos?
Resposta: Não
17. **Questão:** Para o item nº 106 – Gaze Hidrófila: podemos oferecer um rolo de 90 cm x 91 m, malha 12x8, com 730 g em vez de um rolo de 90 cm x 100 cm?
Resposta: Deve oferecer exatamente o que as especificações do produto solicitam, rolo de 90 cm x 100 m.
18. **Questão:** Para o item 50 - Amoxicilina + Ácido Clavulânico suspensão Oral 250mg + 62.5mg/5ml frasco 100ml. Gostaríamos de confirmar se a quantidade é mesmo de 16.670.000 unidades?
Resposta: Sim
19. **Questão:** Para o item 100 - Glutaraldehyde Solution, 2% Vial 5000ml. É glutaraldeído a 2% em água ou em solução tampão? É um recipiente de 5 litros de vidro, plástico ou outro material? Precisam de uma garrafa com tampa de rosca ou em um galão?
Resposta: Solução Tamponada e em galões de plástico, volume final no intervalo de 3.8 á 5L.
20. **Questão:** Para o item 69 - Interferon alfa- 2a Recombinado 3,000,000 IU/0.5mL Injectável, pode ser substituído por Peginterferon alfa-2b?
Resposta: Não. Não são substitutos diretos: Têm regimes de dosagem e intervalos de tempo totalmente diferentes.



21. **Questão:** Solicitamos algumas especificações detalhadas dos seguintes itens:

- 102 - 23A02X Adesivo Esparadrapo (Transpore) Rolo (2,5cm x 5m);
- 103 - 23A08 Adesivo Transparente Rolo 96mm x 5m;
- 104 - 23A10 Adesivo Transparente (Micropore) Rolo 10cm x 10m;
- 105 - 23B01 Algodão Hidrófilo Rolo 500g;
- 106 - 23C03 Gaze Hidrófila Rolo 90 cm x 100 m;
- 107 - 23D03 Ligadura De Cambraia Rolo 10cm x 10m; e
- 108 - 24C01 Sistemas para Soro IV Sistema sem dosagem (Se possível uma imagem ou foto)

Resposta:

102 - 23A02X Adesivo Esparadrapo (Transpore) Rolo (2,5cm x 5m);

- Suporte (Dorso) Película de Poliuretano (PU), transparente, extrafina, com características de elasticidade multidirecional, semipermeável (impermeável a água/bactérias e permeável a vapores e gases).
- Adesivo Poliacrilato hipoalergénico de alta sensibilidade à pressão, com propriedades de retirada atraumática e livre de resíduos pós-remoção
- Proteção (Liner) Poliacrilato hipoalergénico de alta sensibilidade à pressão, com propriedades de retirada atraumática e livre de resíduos pós-remoção.
- Largura Nominal 2,5 cm (Limite de tolerância aceitável: $\pm 10\%$)
- Comprimento Nominal 5 m (Limite de tolerância aceitável: $\pm 1\%$)
- Apresentação Embalado individualmente em bobina/rolo, garantindo a integridade do material até o uso.
- Produto com validade

103 - 23A08 Adesivo Transparente Rolo 96mm x 5m;

- Suporte: Película em poliuretano transparente, transpirável, impermeável e elástico que atua como uma barreira bacteriana eficaz.
- Adesivo: em acrílico hipoalergénico de forte adesão, que permite uma retirada atraumática e sem deixar resíduos.
- Papel de protecção do adesivo: Papel siliconado e graduado de cor branca.
- Largura: Limite de tolerância $\pm 10\%$
- Comprimento: Limite de tolerância $\pm 1\%$
- Produto com validade

104 - 23A10 Adesivo Transparente (Micropore) Rolo 10cm x 10m;

- Suporte (Dorso) Película de Poliuretano (PU) transparente, de alta permeabilidade a vapores e gases (transpirável), porém impermeável a líquidos e microrganismos. Material elástico que atua como barreira bacteriana e viral eficaz.
- Adesivo Acrílico hipoalergénico de forte adesão inicial e mantida. Formulado para permitir uma retirada atraumática, minimizando lesões na epiderme e sem deixar resíduos de cola na pele.
- Papel de Proteção (Liner) Papel siliconado de cor branca, graduado (quadriculado) para facilitar o corte preciso conforme a necessidade do curativo.
- Largura Nominal 10 cm (Limite de tolerância: $\pm 10\%$)
- Comprimento Nominal 10 m (Limite de tolerância: $\pm 1\%$)
- Apresentação Rolo individual, permitindo o corte customizado.
- Produto com validade

105 - 23B01 Algodao Hidrofilo Rolo 500g



CMAM
Central de Materiais
e Artigos Médicos

Av. de Moçambique, EN1, Bairro do Zimpeto Nrº 847
Cidade de Maputo

- Algodão 100% puro não estéril
- Macio e extra-absorvente
- Dermatologicamente testado
- Ausência de grumos, resíduos ou quaisquer outras impurezas
- Ser inodoro
- Cor branca
- Embalagem: Rolo 500g
- Embalado em papel ou saco plástico individual.
- Peso: Limite de tolerância $\pm 5\%$
- Produto com validade

106 - 23C03 Gaze Hidrófila Rolo 90 cm x 100 m

- Confeccionada com fios de algodão 100% puro não estéril, transformados numa tela.
- Altamente absorvente, macia e que sofre um tratamento que a torna isenta de impurezas.
- As dobras das laterais são viradas para dentro
- Com aurela como acabamento de forma a evitar o desfiamiento.
- Pela sua composição não detectável ao Raio-X
- Embalagem: Rolo de 90cm por 100metros
- Não estéril
- Embalado com uma camada de papel protector ou saco plástico.
- Largura: Limite de tolerância $\pm 5\%$
- Comprimento: Limite de tolerância $\pm 1\%$
- Malha: 17 fios/cm².
- Produto com validade
- **Peso: $\geq 2,4$ Kg;**
- Fios de Urdidura (Warp): 95 a 105 fios/dm;
- Trama (Weft): 66 a 74 fios/dm



107 - 23D03 Ligadura De Cambraia Rolo 10cm x 10m;

- Malha de 7 fios/cm²
- Sem ourela
- Embaladas individualmente em celofane + em caixa de 12 + caixa de transporte
- malha: 7 fios/cm²
- Peso: aprox. 13,5g/m².
- Peso: Limite de tolerância $\pm 10\%$
- Largura: Limite de tolerância $\pm 10\%$
- Comprimento: Limite de tolerância $\pm 1\%$
- Produto com validade

108 - 24C01 Sistemas para Soro IV Sistema sem dosagem

- Suporte (Estrutura)Tubo flexível em PVC (Policloreto de Vinila)
- Transparente para visualização de bolhas de ar, atóxico e apirogénico
- Sistemas para Soro IV (injector lateral e conector Luer Slip)
- Comprimento da mangueira 150 cm
- Ponta perfurante, 1ml = 20gotas/minuto
- Câmara gotejadora transparente com filtro de 15 μ m
- Entrada de ar com filtro de bactérias de 0.22 μ m
- Tubo PVC

- Pinça rolete para controle do fluxo de infusão
- Injector lateral com membrana auto cicatrizante
- Isento de latex e
- Conector spin lock com o paciente, com fluid stop.
- **Injetor Lateral Dispositivo em "Y" com membrana autocicatrizante (isento de látex) para administração de medicamentos secundários.**

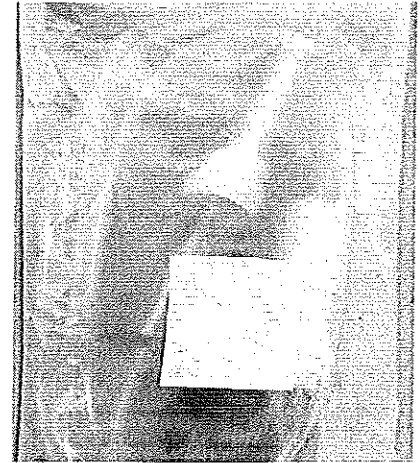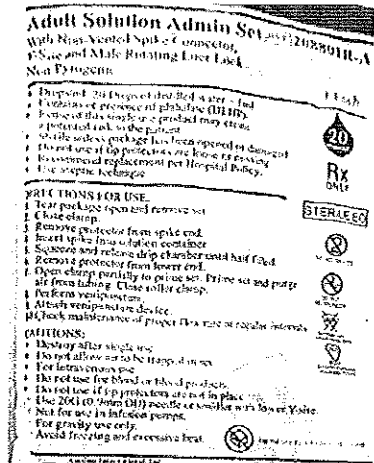

22. **Questão:** Em relação às seringas para insulina que devem ser cotadas no concurso, quais devem ser as especificações técnicas adequadas da mesma incluindo tamanho?

Resposta: As especificações técnicas devem ser de acordo com o seguinte:

- Cilíndrica
- Transparente
- Graduada
- Agulha fixa de 8x0.30mm
- Atóxica e a pirogênica
- Fabricada em polipropileno
- Estéril,
- Capacidade: 100 UI, escala de graduação de 2UI,
- Posição do Canhão: central
- Embalagem: individualizada em filme termoplástico e em papel grau cirúrgico
- Uso único.

23. **Questão:** Item 24C01 - Sistema para Soro Intravenoso, há necessidade de alguma amostra para o mesmo?

Resposta: Sim, deve ser apresentada amostra do produto.

Sem outro assunto de momento, subscrevemo – nos com elevada estima e consideração.

O Chefe de Departamento

Ernesto Sambo
(Jurista A)



ES//esm



CMAM
Central de Medicamentos
e Artigos Médicos

Av. de Moçambique, EN1, Bairro do Zimpeto Nrº 847
Cidade de Maputo